

演習課題 M05：「質量分析器を組み立ててみよう」

[目的]


質量分析法は、物質の組成を分析する重要な手段の一つである。本演習では、電子衝撃型質量分析器の組み立て、真空立ち上げ、レンズ系および検出器の調整を行なうことにより質量分析法の原理を理解すること、実際に簡単な分子の質量分析スペクトルの測定を行うことにより電子衝撃による分子の電離過程および引き続く解離過程について考察を行う。

[原理]

質量分析に用いられる機器として、磁場偏向型質量分析器、4重極質量分析器、飛行時間型質量分析器などが挙げられるが、これらの質量分析計に共通しているのは、試料をイオン化して、それらのイオンを電磁気力によって質量電荷比 (m/q) に応じて分離して検出していることである。

イオンに働く電磁気力の違いによって m/q を分離しているため、質量分析をおこなう際には、どのように試料をイオン化するかがとても大切な問題になる。田中耕一さんは、ソフトレーザー脱離イオン化法の発明が認められ、ノーベル化学賞を受賞した。

本演習では、比較的簡単な操作である飛行時間型質量分析器 (TOF-MS) を用いる。下図には、TOF-MS の原理を理解するため、簡単な 1 段加速方式の TOF-MS を示す。TOF-MS の原理は、直感的には“かけっこ”である。スタート地点（電場 E の中央の●）に整列した種々

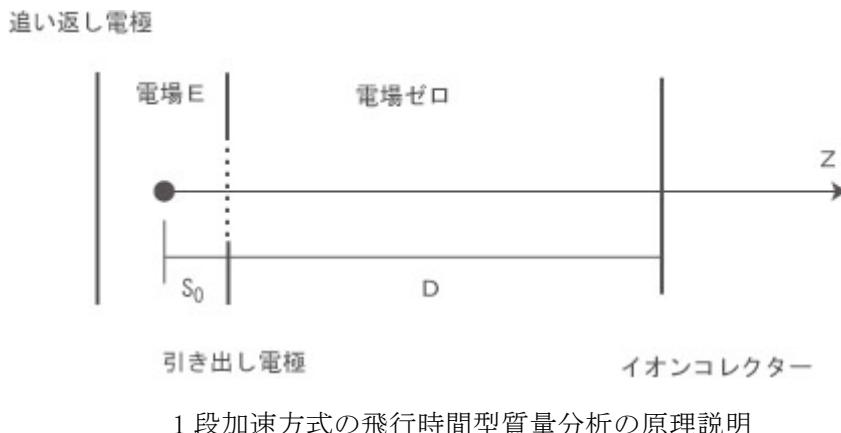

のイオンが、「よーいドン」で一斉にゴール（イオンコレクター）に向かって走り出す。イオンがゴールに到達する時間は m/q に依存するため、 m/q の分離を行うことができる。具体的には、追い返し電極に正パルスを与え、生成したイオンが追い出される時間からイオンコレクターに到着する時間を飛行時間として測定する。なお飛行時間と m/q の関係式は簡単に導出できるので確かめてほしい。